


## TELESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 30°, ileri oblik görüşlü olmalıdır.
- 4 mm çapa sahip olmalıdır.
- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- Teleskop uç kısmı altın lehimle kaplı olmalı, bu sayede daha uzun süre sıvı sterilizasyon yapılabilir.
- Teleskop, çalışma elemanına pim aracılığı ile bağlanmalıdır. OLYMPUS markalı WA22366A kod numaralı aktif çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır. Çevirmeli kilit uyumlu teleskoplar kabul edilmeyecektir.
- Sterilizasyon amaçlı otoklavlanabilir plastik taşıyıcısı ile birlikte verilmelidir.
- Teklif veren firma teklif ettiği ürünün üreticisi ise üreticisi olduğuna dair belgeleri, yetkili Türkiye distribütörü ise teklif verdiği tarih itibariyle yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgeleri teklif dosyasında sunması zorunludur. Teklif veren firma bayi ise, teklif verilen tarih itibariyle yetkili Türkiye distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belgeleri sunması zorunludur.

Prof. Dr. Tolha M. Geyikçi

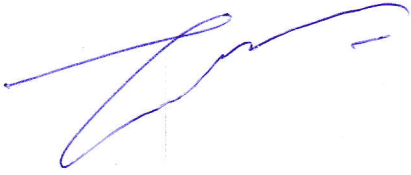

Prof. Dr. Oğuzhan

