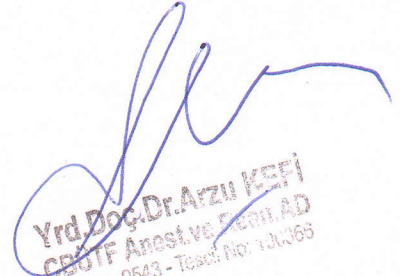


HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODU (Psewar)

- 1- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- Valleyleb katetere uygun olmalıdır.
- 3- Pozisyon değişikliklerinden etkilenmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Hastayla temas eden bölümü yapışkan ve yumuşak olmalıdır.
- 5- Yapışkan bölümün koruyucusu olmalıdır.
- 6- CE standartlarına uygun olmalıdır.
- 7- Kablo uzunluğu 2-60 2-70cm olmalıdır.
- 8- Elektrodun boyutları 18x11cm boyutlarında olmalıdır.
- 9- Dönüş elektrodunun metal kısmı birbirinden ayrı iki bölgeden oluşmalıdır. Kullanılan elektrokoterin REM hasta emniyet sistemine uyum göstererek, dönüş elektrodu altında meydana gelebilecek yanıkların önlenmesi için % 100 güvence vermelidir.
- 10- Valleyleb kotere uyumlu aksesuarla birlikte verilmelidir.
- 11- Her 25 adet ürüne 1 adet valleyleb marka kotere uyumlu 2,5 – 3 metre psewar kablosu verilmelidir.
- 12- Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denedikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
- 13- ÜTS' kayıtlı olmalıdır.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBOTF Anest. ve Fern. AD
Dip. No. 9543 - Tevdi. No. 100365